PHILIPS

お客様各位

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
ＡＥＤコールセンター
電話番号：０１２０－８０２－３３７
０３－３７４０－３２６９
受付時間：９：００－１８：００
（土、日、祝日、年末年始を除く）

ＡＥＤ設置時の安全対策のお願い

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。さて、当社製ＡＥＤの設置者または点検担当者の皆様に日常点検等を実施していただきますようお願い申し上げます。

敬具

1．日常点検項目

1）ＡＥＤ本体右上の緑のインジケータランプまたは黒の砂時計マークのステータスインジケータが点滅していることを確認する。
2）ＡＥＤ消耗品（パッドとバッテリ）の交換時期を確認する。
3）ＡＥＤの外観を確認し、損傷等の異常が無いことを確認する。

異常があった場合は取扱説明書のテストとトラブルシューティング、添付文書等を参照願います。

2．ＡＥＤ消耗品交換時期ラベルの記入

1）パッドの次回交換時期

パッドの袋の砂時計マーク 横の“USE　BEFORE”または“EXP−DATE”の年月を「ＡＥＤ消耗品交換時期」ラベルのパッド　成人または小児　次回交換欄に記入をお願いします。

例）２０１２－０５、０５／２０１２、０５－２０１２の場合は　**２０１２年５月**がパッドの次回交換時期になります。

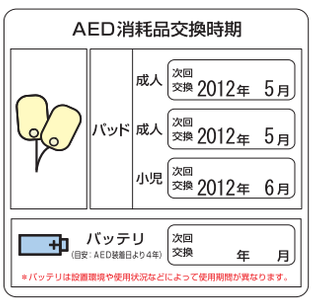

2）バッテリの次回交換時期（目安）

ＡＥＤの設置環境や使用状況により、バッテリの次回交換時期が異なります。次回交換時期は目安となりますのでご了承願います。
未使用のバッテリをＡＥＤに装着した月から**４年後（目安）**の年月を「ＡＥＤ消耗品交換時期」のラベルのバッテリ欄に記入をお願いします。

例）未使用のバッテリをＡＥＤに装着した年月が２００９年５月の場合は、上記の年月に**４年**を加算した年月、**２０１３年５月**が次回交換の目安になります。

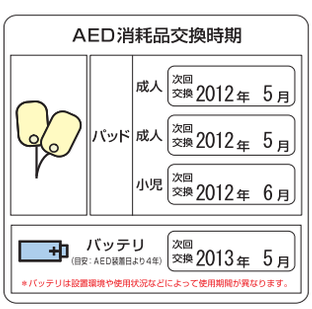

３．ＡＥＤ消耗品交換時期ラベルの表示

1）プレートまたはＡＥＤキャビネット等の前面に「ＡＥＤ消耗品交換時期」ラベルを貼ります。ラベル裏面の保護シールを剥がして貼ってください。



ラベルをプレートに貼った例

ラベルを直接キャビネットに貼った例

2）ストラップのくびれ側をプレートの穴に通します。

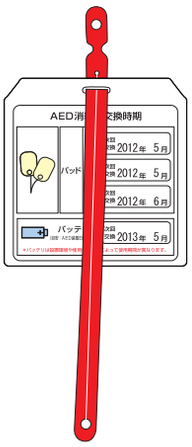

3）ストラップの反対側をくびれ上部の穴に通します。



４．キャリングケース等の取手にプレートを取付ける

ストラップをプレートに取付けた後、キャリングケース等の取手部分にストラップをくぐらせて取りつけてください。

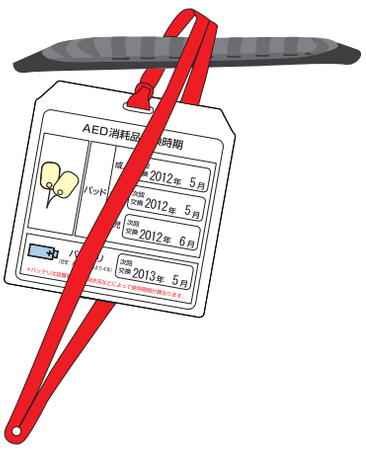

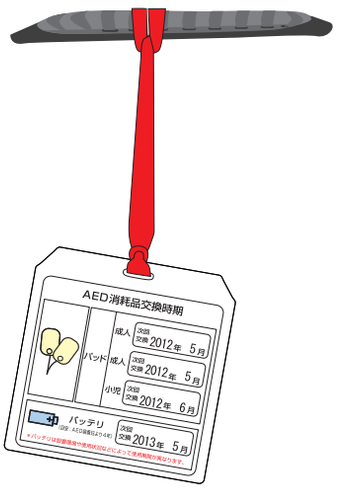

５．表示内容の視認性

通常の収納状態で表示内容が容易に確認できるように、プレートの取付けまたはラベルの貼付けをお願いします。

プレートをキャリングケースに取付けた例

ラベルを直接キャビネットに貼った例